

ด้านที่ 2

ข้อ 11 (HS11)

แผนกสูติกรรม

ห้องคลอด โรงพยาบาลพระอาจารย์ม้น จูริทัตโต มี 1 ห้อง ให้บริการคลอดปกติและมีสูติศาสตร์หัตถการ และเพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน พร้อมใช้งาน จึงมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอและพร้อมให้บริการ และจัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้


- 1) เตียงทำคลอดและโคมไฟ
- 2) เตียงรอกคลอดอย่างน้อยหนึ่งเตียงต่อเตียงทำคลอดหนึ่งเตียง
- 3) เตียงทารกแรกเกิด
- 4) ชุดอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพทุกห้อง
- 5) ระบบแก๊สทางการแพทย์เครื่องดูดเสมหะ และอุปกรณ์ช่วยหายใจ
- 6) เครื่องมือทำคลอดจำนวนที่เพียงพอและได้มาตรฐานทางการแพทย์
- 7) เครื่องตรวจสัญญาณชีพทารกในครรภ์
- 8) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ำ
- 9) อ่างอาบน้ำทารก
- 10) เครื่องซั่งน้ำหนักทารกแรกเกิด

มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด

1.เตียงทำคลอดและโคมไฟ



2.เตียงรอกคลอดอย่างน้อยหนึ่งเตียงต่อเตียงทำคลอดหนึ่งเตียง

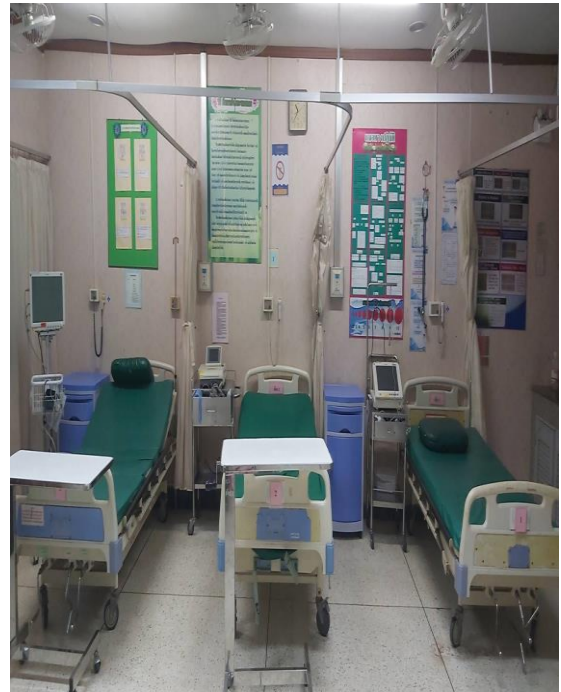

3) เตียงทารกแรกเกิด



5) ระบบแก๊สทางการแพทย์เครื่องดูดเสมหะ และอุปกรณ์ช่วยหายใจ



6) เครื่องมือทำคลอดจำนวนที่เพียงพอและได้มาตรฐานทางการแพทย์




7) เครื่องตรวจสัญญาณชีพทารกในครรภ์



8) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ำ



9) อ่างอาบน้ำทารก

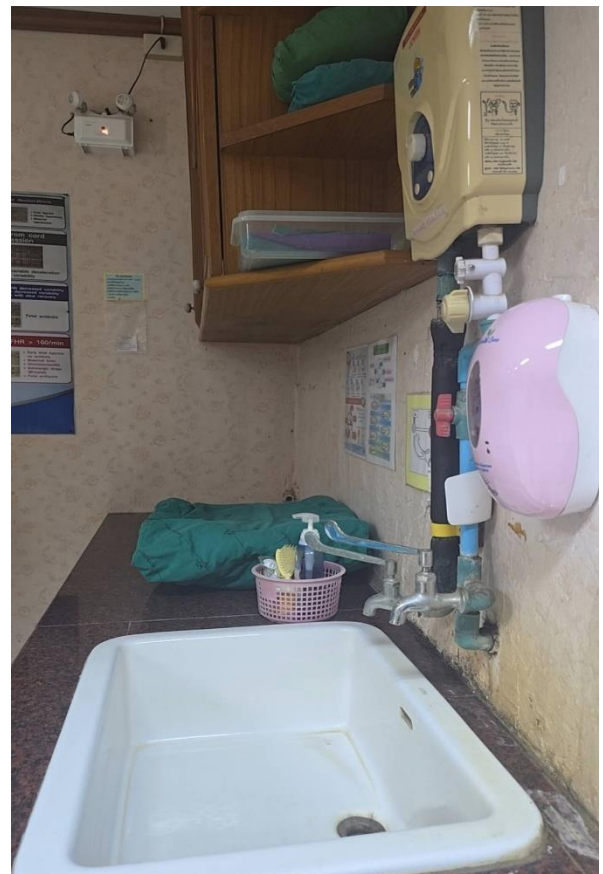

10) เครื่องชั่งน้ำหนักทารกแรกเกิด

