



6.1.2 ผู้ใช้ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการแพทย์ต้องมีสมรรถนะที่เหมาะสมตามมาตรฐานของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือตามประกาศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1) ใบรับรองเจ้าหน้าที่สอบเทียบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอที พรวิวัฒน์ แอนด์ คาลิเบรชั่น (out sources )

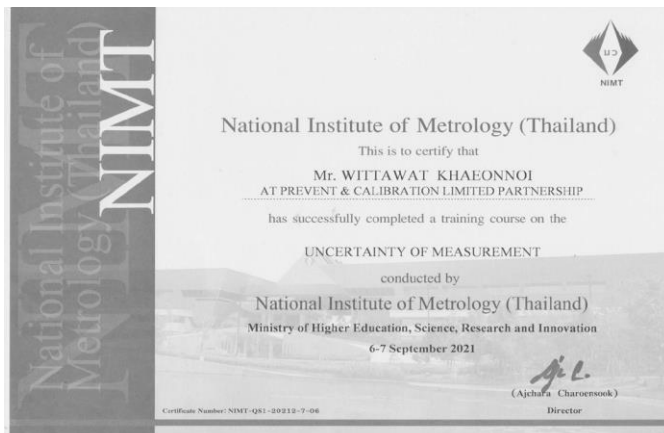

2) ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการแพทย์ในโรงพยาบาล

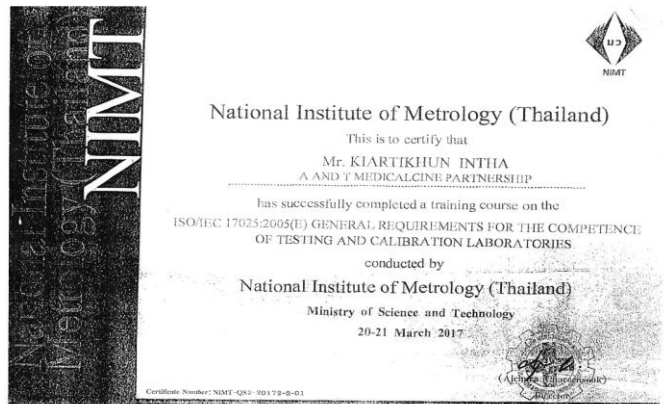

3) Medical Device Standard Test and Calibration 2026 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอที พีริแวนท์ แอนด์ คาลิเบรชั่น (out sources )

